

Số: 4260/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi:** Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống nội soi hãng KarlStorz tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Nguyễn Đức Linh, Phòng vật tư, TBYT, Điện thoại: 0913 672 290.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, TBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 02 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá: (chi tiết như phụ lục đính kèm).


Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; PVT TBYT; TCKT.

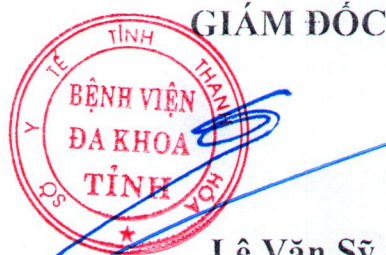


Lê Văn Sỹ

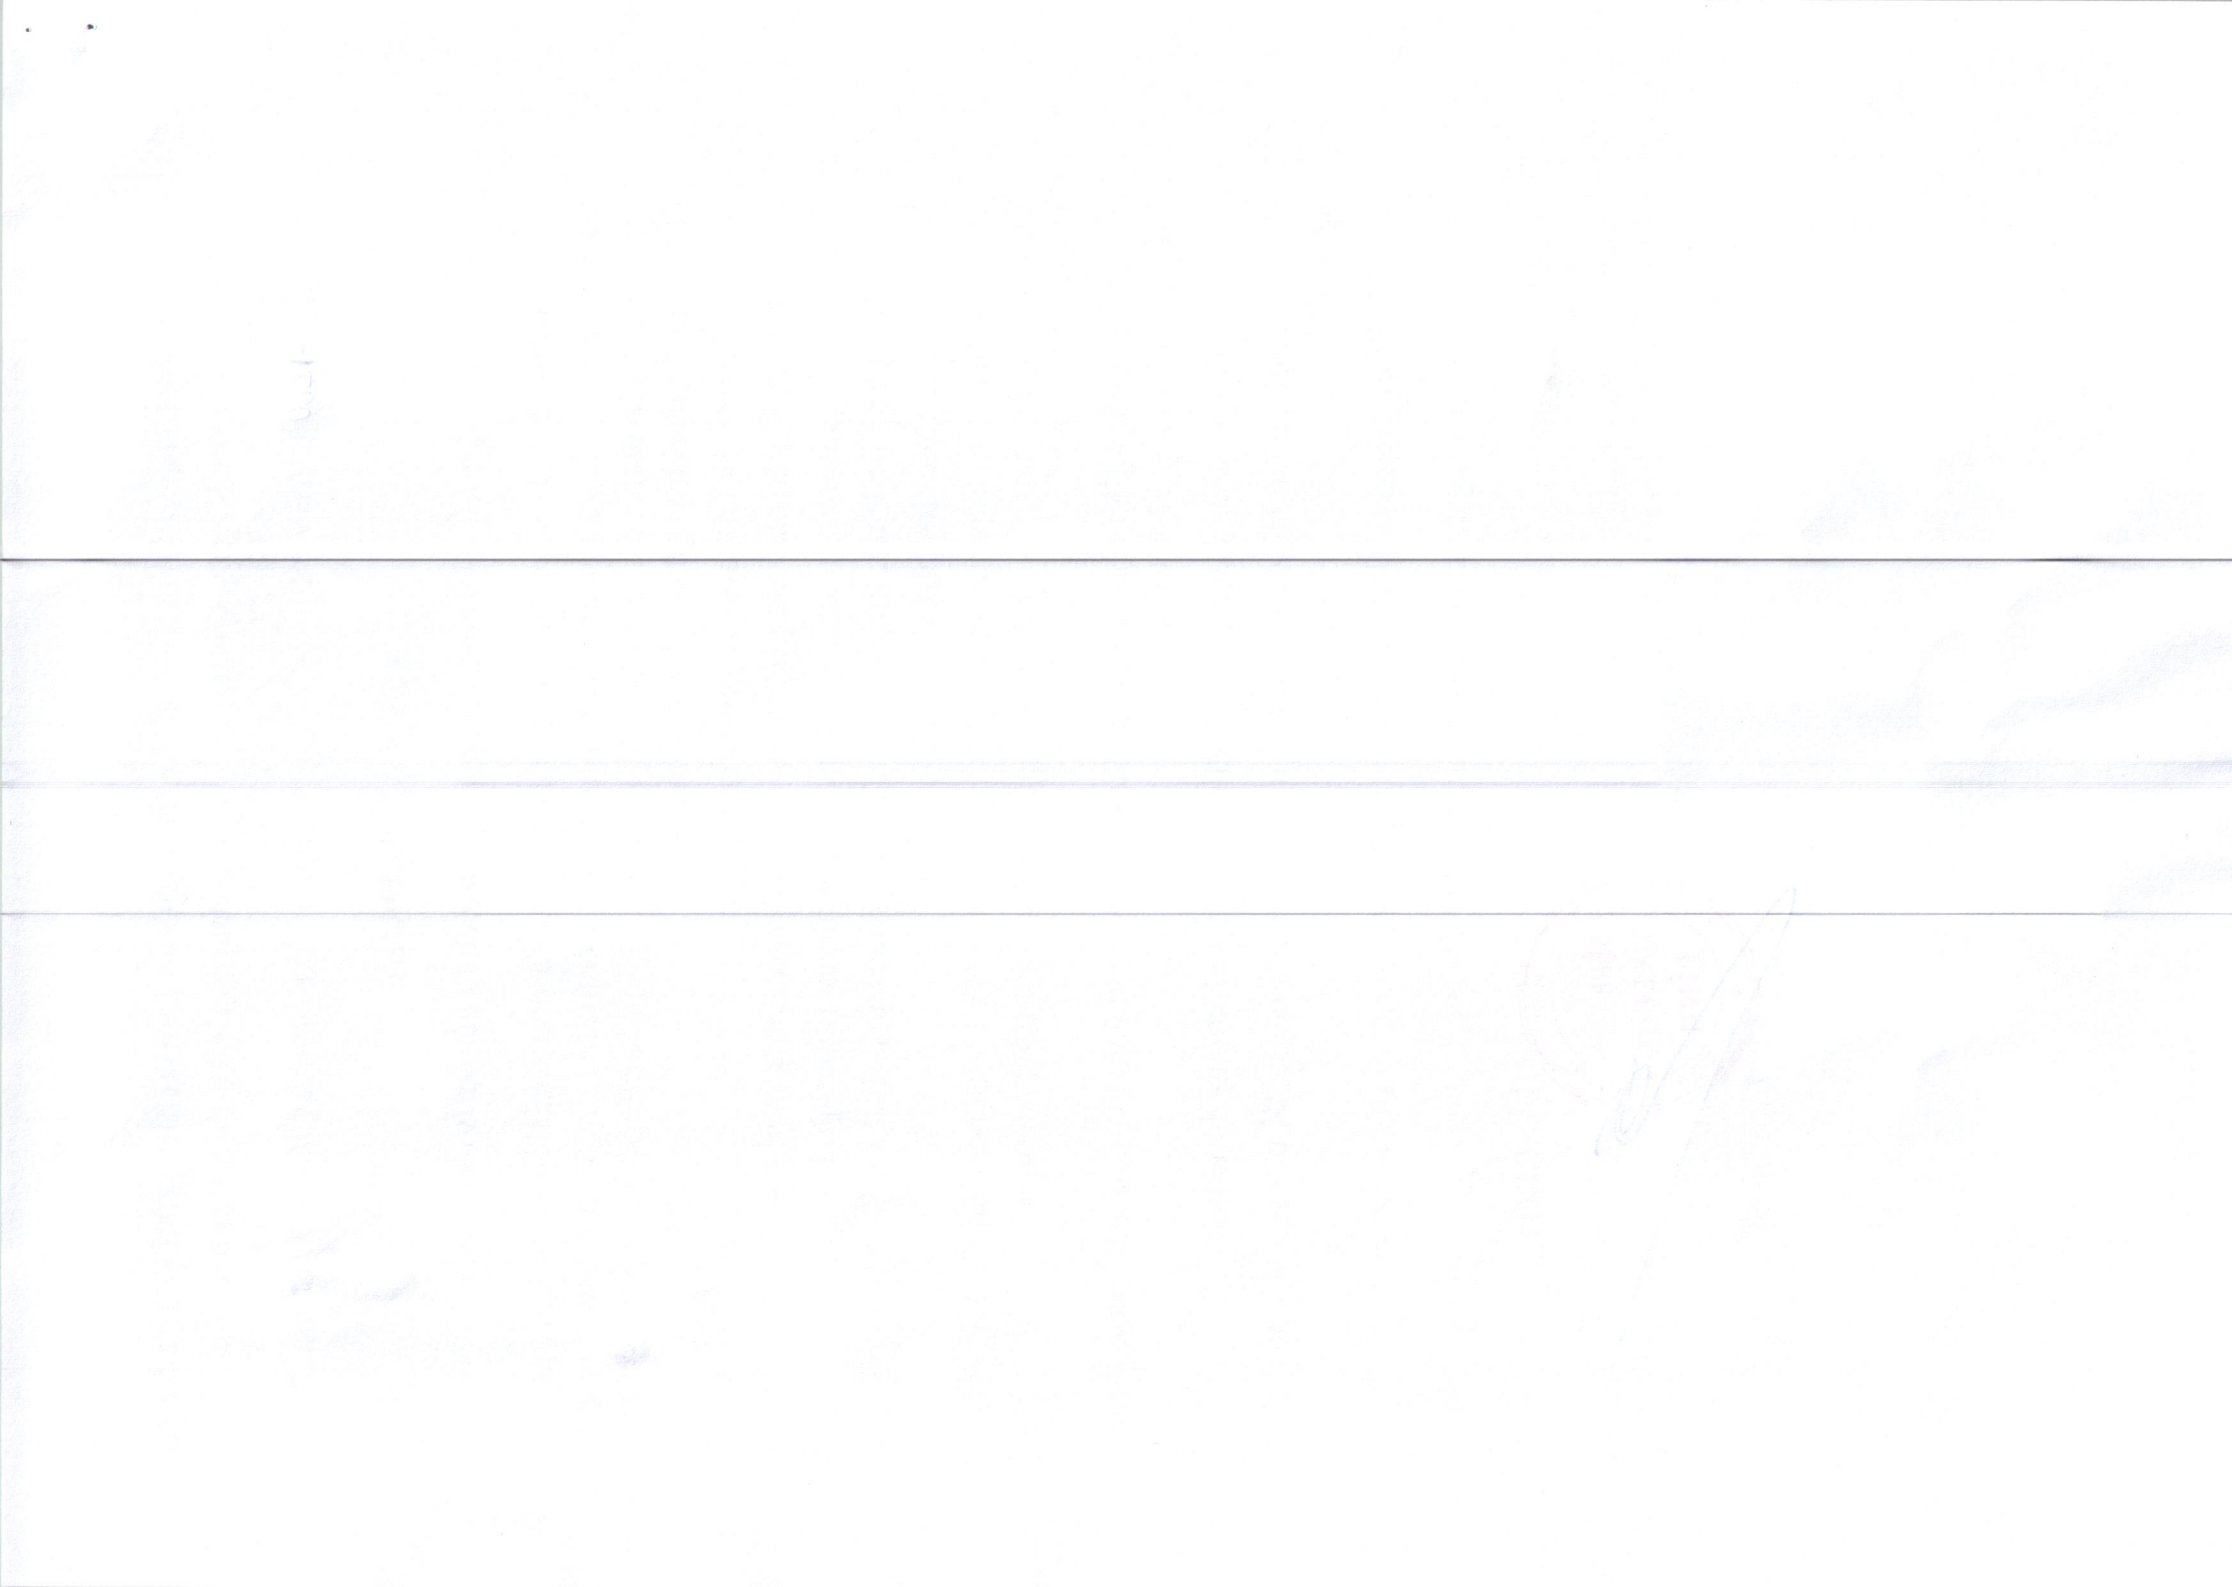



**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 426/CV-BVĐK ngày 24 tháng 11 năm 2023)



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa hệ thống nội soi <b>KARLSTORZ:</b> Hãng sx: KARLSTORZ Xuất xứ: Đức		03	Hệ thống	Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Thanh Hóa	Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
1.1	Sửa chữa đầu camera Tricam -Model : 20221030 -Seri number : NZ757935 - H	- Sửa chữa bộ gá và lò xo giữ ốp tích. - Cam kết điều kiện bảo hành thiết bị sau khi sửa chữa và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa.	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
1.2	Sửa chữa đầu camera Image1S -Model : TH100 -Seri number : XT880683 - H	- Sửa chữa chức năng zoom quang học. - Cam kết điều kiện bảo hành thiết bị sau khi sửa chữa và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa.	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa	Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
1.3	Sửa chữa Module Image1 S connect -Model : TC200 -Seri number : NP822297 - P	- Sửa chữa tấm dán mặt công tắc. - Cam kết điều kiện bảo hành thiết bị sau khi sửa chữa và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa.	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa,	Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

